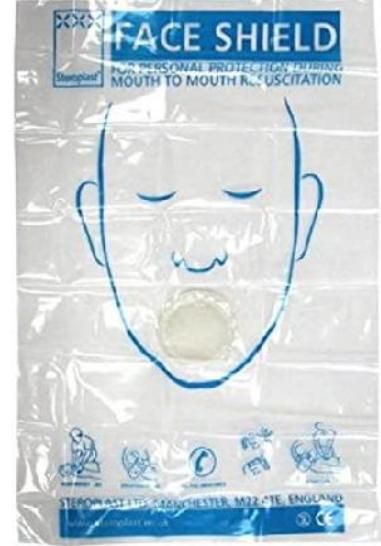
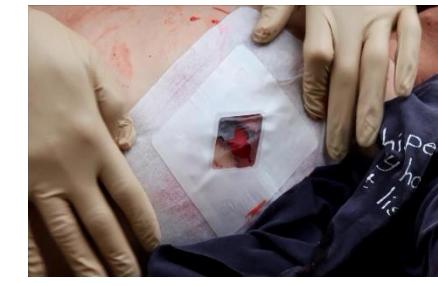


Relação de produtos Aprovados Anvisa:

PFM INC			
Modelo/ Código: <i>Model/ References</i>	Número de Registro Anvisa: <i>Anvisa Registration Number</i>	Descrição do produto/Finalidade: <i>Product Description/Purpose:</i>	Imagen: <i>Image:</i>
1 ASEPT® 2000ml Drainage Bag/ M7058	82673289025	A bolsa de drenagem ASEPT® de 2.000mL tem a finalidade de ser usada para drenagem peritoneal em conjunto com o sistema de drenagem peritoneal ASEPT®. Esta bolsa de 2.000mL é embalada estéril, dez unidades por caixa e possui uma linha de drenagem estendida com o conector ASEPT® conectado à extremidade da linha para fácil conexão.	
2 ASEPT® Replacement Valve/ M7004	82673280007	A válvula de substituição ASEPT® destina-se a substituir a válvula anexada ao ASEPT® Pleural ou Peritoneal Cateter de Drenagem em caso de oclusão ou mau funcionamento.	
3 JET-VAC Drainage Bottles. M7090 - Drainage Bottle 1000 mL M7092 - Drainage Bottle 600 mL M7093 - Drainage Bottle 1500 mL	82673289026	O Jet-Vac® drainage bottles tem a finalidade de ser usada para drenagem torácica através de um sistema a vácuo. É um reservatório para ser conectado a um dreno que permite o fluxo direto do fluido da drenagem no cateter implantado no paciente para o frasco Jet-Vac.	

<p>4</p> <p>JET-VAC Drainage Bottle w drain line.</p> <p>M7094 - Drainage Bottle w drain 1000mL</p> <p>M7095 - Drainage Bottle w drain 1500mL</p> <p>M7096 - Drainage Bottle w drain 600ml</p>	<p>82673289024</p>	<p>O Jet-Vac® drainage bottles w/line tem a finalidade de ser usada para drenagem torácica através de um sistema de vácuo. É um reservatório conectado a uma linha que deverá ser conectado a um dreno a fim de promover sucção de secreção em drenagem torácica.</p>	
<p>5</p> <p>ASEPT® Drainage Bottle.</p> <p>M7070 - Drainage Bottle 1000 ML.</p> <p>M7072 - Drainage Bottle 600 ML.</p>	<p>82673289022</p>	<p>O ASEPT® Drainage Bottle de 600ml ou 1.000ml sem linha de drenagem é uma garrafa de sucção portátil, para um único paciente, usado para aspirar, remover ou coletar fluidos corporais para a drenagem peritoneal e pleural. A garrafa vem com uma válvula sem agulha anexada à garrafa.</p>	
<p>6</p> <p>ASEPT® Drainage Line Set/</p> <p>M7005</p>	<p>82673289023</p>	<p>ASEPT® A linha de drenagem ASEPT® tem a finalidade de se conectar ao cateter de drenagem pleural ou peritoneal ASEPT® para uma sucção de fluidos patológicos ou aumentados, a fim de restaurar um estado normal. Um adaptador para tubo de drenagem está incluído. A linha de dreno é embalada individualmente e acompanha um adaptador para tubo de drenagem</p>	

7 5706_JET-VAC Acessories M7097- Extension Drainage Line 10uni por caixa. M7098- Drainage Line 5 uni por caixa. M7099- Drainage Line 10 uni por caixa.	82673280008	<p>O JET-VAC Accessories são linhas de drenagem com a finalidade de se conectar ao cateter de drenagem percutânea JET-VAC para uma sucção de fluidos patológicos ou aumentados durante o procedimento de paracentese, a fim de restaurar um estado normal.</p>	
Kit Militar			
8 FACE SHIELD RESUSCIADE /RE0120	82673280009	<p>Máscara facial designado para proteção pessoal durante a ressuscitação cardiopulmonar. - Foi especialmente desenvolvida em plástico impermeável, com uma válvula que impede o retorno de ar e evita qualquer tipo de contato com fluídos da vítima, evitando riscos de contaminação, prevenindo o contágio contra vírus, bactérias.</p> <p>- Os protetores faciais são uma peça essencial do kit para paramédicos e socorristas.</p>	

<p>9 Torniquete Mecânico Tático (TMT) PDF187</p>	<p>82673280010</p>	<p>O Torniquete Tático Mecânico (TMT) é um molinete torniquete. O dispositivo consiste em uma alça com gancho e laço e um fivela plástica rígida, receptor, placa de controle, e barra de torção. É um dispositivo usado para aplicar pressão circumferencial em uma extremidade para obstruir o fluxo de sangue distal ao local onde é aplicado.</p> <p>- O TMT foi projetado para garantir facilidade de aplicação, controlar definitivamente a hemorragia e eliminar as atuais taxas de “porcentagem de falha” do torniquete.</p> <p>Como o controle da hemorragia é ensinado como uma tarefa de autoajuda/ajuda, o projeto pré-fabricado do TMT requer treinamento mínimo para tratar instantaneamente uma hemorragia de uma extremidade com risco de vida.</p>	
<p>10 Russel Chest Seal/ IN0680</p>	<p>82673280011</p>	<p>O Russell Chest Seal® é um curativo à base de hidrogel com uma válvula de baixo perfil integral com quatro aberturas. O material de base da vedação no tórax é uma matriz de hidrogel, que compreende um gel com água, instalado num tecido não tecido com revestimentos de silicone.</p> <p>O Russell Chest Seal® é usado para cobrir feridas torácicas penetrantes e o mecanismo de válvula permite que o ar saia da cavidade pleural sem que volte a entrar. O objetivo é minimizar o colapso pulmonar associado a</p>	

		<p>esta lesão e facilitar a reinsuflação pulmonar. O dispositivo irá permanecer no sítio durante várias horas e apresenta conforto para o paciente durante uma utilização prolongada.</p> <p>Na inspiração, mesmo uma pequena pressão negativa irá fazer a válvula fechar, mesmo na presença de fluidos como sangue. Durante ciclos respiratórios repetidos, o ar pode sair pela vedação a cada expiração e os pulmões irão expandir-se um pouco mais a cada inspiração. Gradualmente, os pulmões irão encher-se novamente e a oxigenação deve melhorar.</p> <p>O Russell Chest Seal® não tem peças em látex e foi concebido para permanecer altamente oclusivo de forma a tornar a vedação eficaz.</p>	
11 Foil Blanket FAO760	82673280013	<p>O FOIL BLANKET é um cobertor de alumínio, também conhecido como cobertor espacial, é um método eficaz de prevenção contra a hipotermia. O uso de uma manta de sobrevivência ou manta de radiação ajuda o corpo a reter o calor do próprio corpo, refletindo o calor que escapa de volta para o corpo. Cobertores de alumínio são considerados como um item essencial em qualquer kit de primeiros socorros. Este cobertor pode ser usado para manter uma pessoa aquecida após lesão ou choque</p>	

12 Emergency Bandage FCP-02	82673280015	<p>A Bandagem de Emergência tem capacidade eficiente de estancar o sangue e oferece facilidade de operação ideal para ambientes táticos.</p> <p>A Bandagem de Emergência consolida vários equipamentos de tratamento em uma única unidade e fornece em um único dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Almofada não aderente. Eliminando o risco de causar dor e reabrir a ferida após a retirada do curativo.- Aplicador de pressão. Criando a pressão direta imediata no local da ferida.- Curativo estéril secundário. Mantem a área da ferida limpa a almofada e mantém a pressão sobre a ferida firmemente no lugar, incluindo a imobilização do membro ou parte do corpo lesionado.- Barra de fechamento. Possibilita o fechamento e fixação da Bandagem de Emergência em qualquer ponto, em todas as partes do corpo: sem alfinetes e clipes, sem fita, sem velcro, sem nós.- Aplicação e Autoaplicação rápida e fácil. Projetado pensando no usuário final; para o treinado em primeiros socorros e para o cuidador leigo.- Tempo significativo por tratamento e economia de custos.	
--	-------------	---	---

<p>13 Sterotape FA0331</p>	<p>82673280014</p>	<p>O Sterotape é uma fita microporosa indicada para fixar curativos e bandagens na pele do paciente. O material respirável da fita microporosa torna-a confortável de usar como um adesivo adequado para a pele que pode ser facilmente removido quando necessário. Juntamente com o uso regular em tratamentos de feridas, a fita microporosa é útil para segurar cateteres no lugar com segurança.</p> <p>Alguns pacientes usam fita microporosa para auxiliar na cicatrização de cicatrizes cirúrgicas como parte da cura pós-operatória. Aplicada sobre a área de cicatrização de uma ferida, a fita microporosa pode fornecer tensão sobre a pele e o tecido danificados, promovendo a cicatrização e reduzindo o risco de desenvolvimento de cicatrizes problemáticas ao longo do tempo.</p> <p>Sem látex e hipoalergênico, o Sterotape microporoso é adequado para pacientes com pele sensível, incluindo crianças e idosos.</p> <p>Normalmente, o Sterotape que cobre uma incisão permanece presa ao corpo por 3 a 10 dias e cai sozinha, não havendo um momento específico para a remoção.</p> <p>O Sterotape usado para segurar os curativos só precisa ser trocada quando o próprio curativo for trocado.</p>	
---	--------------------	--	---

<p>14 Compressed Gauze HHPG-C-CA</p>	<p>82673280018</p>	<p>Os curativos são confeccionados com fio de algodão e o produto é esterilizado. As gazes destinam-se a curativos clínicos e fixação. Pode ser amplamente utilizado para kit de primeiros socorros, treinamento e tratamento de feridas. É adequado para a maioria da população.</p>	
<p>15 STEROCREPE FA0384</p>	<p>82673280016</p>	<p>O STEROCREPE é uma bandagem de crepe feita de algodão elástico respirável para compressão moderada e confortável. Uma superfície texturizada mantém as bandagens no lugar. É uma bandagem de crepe premium de alta qualidade, ideal para dar suporte leve a entorses e distensões nas articulações e músculos. Também funciona como uma bandagem de compressão moderada para aliviar o inchaço dos joelhos, tornozelos e lesões musculoesqueléticas semelhantes, graças à sua capacidade de reduzir a inflamação. A superfície texturizada do STEROCREPE proporciona excelente tração, tornando-o ideal para fixar curativos com leve suporte. Primeiros socorros: além das aplicações para lesões esportivas, a bandagem crepe pode ser usada para envolver membros</p>	

		<p>lesionados em diversas situações de primeiros socorros. A bandagem crepe também é usada para cobrir e proteger curativos e mantê-los no lugar, sendo um complemento regular aos kits de primeiros socorros</p>	
<p>16 NASOSAFE AM0219</p>	<p>82673280020</p>	<p>O Nasosafe consiste em um tubo curvo com topo chanfrado que auxilia na inserção e possui bordas lisas e arredondadas para evitar trauma na membrana. O punho giratório de segurança na extremidade dos alargamentos repousa contra a narina para evitar trauma na membrana.</p> <p>O NasoSafe destina-se a ser inserido através de uma narina para fornecer uma abertura para manter a permeabilidade das vias aéreas de um paciente quando o acesso pela boca não é possível ou desejável.</p> <p>O NasoSafe também pode ser usado como um conduíte para outros dispositivos médicos, como cateteres de sucção.</p> <p>O NasoSafe destina-se ao uso em ambientes de emergência, pré-hospitalares, hospitalares e domiciliares por profissionais treinados.</p>	

<p>17 Prometheus Trauma Dressing</p>	<p>82673280021</p>	<p>O curativo para trauma Prometheus (PTD) foi projetado para controlar sangramento moderado em feridas na pele ou mucosa. Por ser menor que a maioria, cabe facilmente em bolsas e kits médicos e é ideal para o ambiente tático. As tiras de gancho, que aderem à bandagem elástica de compressão, evitam que o rolo elástico se desfaça accidentalmente e fixam a bandagem durante todo o processo de aplicação. A grande almofada de baixa aderência combinada com o envoltório elástico proporciona uma compressão verdadeiramente eficaz. É indicado que permaneça na pele ou mucosa durante o transporte do paciente até o hospital ou até que curativo esteja saturado.</p>	
<p>18 Disposable IV Catheter ZLZ0714</p>	<p>82673289050</p>	<p>O cateter IV descartável destina-se a ser inserido no paciente sistema vascular periférico para uso de curto prazo para coletar amostras de sangue ou administrar fluidos.</p>	 14

PFM mepro			
19 RENDON BOTTLES OR-system/ 20304 20301 20204 20201 20404 20401	82673289030	<p>É um sistema de drenagem de feridas de alto vácuo, indicado para drenagem, coadaptação e fixação das bordas de uma ferida.</p> <p>Os Rendon Bottles OR-system é composto por um reservatório evacuado (alto vácuo), e uma tubulação de conexão (OR) que será conectado a um dreno (objeto de outro registro), a fim de promover sucção/limpeza de sangue e secreção. A escala e display de vácuo que está fixado na garrafa não é aferido ou calibrado, é apenas para fins informativos. O Dispositivo não é conectado a nenhum tipo de equipamento. É recomendado a troca do dispositivo antes de 30 dias ou até que o reservatório esteja cheio, o que acontecer primeiro.</p>	
20 RENDON BOTTLES WARD-system/ 20200 20203 20300 20303 20400 20403	82673289036	<p>É um reservatório de drenagem de feridas de alto vácuo, indicado para drenagem, coadaptação e fixação das bordas de uma ferida.</p> <p>Os Rendon Bottles ward-system é composto por um reservatório evacuado (alto vácuo), que é conectado através a um dreno (objeto de outro registro) a um a fim de promover sucção/limpeza de sangue e secreção. A escala e display de vácuo que está fixado na garrafa não é aferido ou calibrado, é apenas</p>	

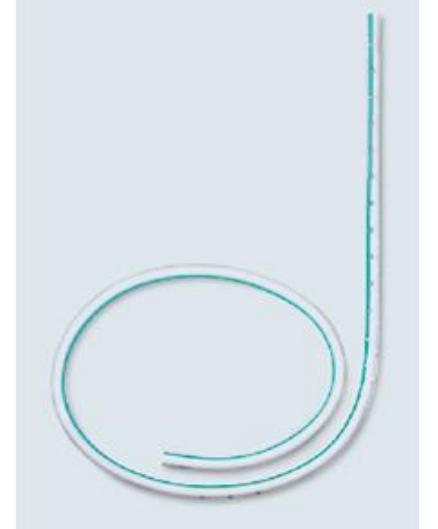
		<p>para fins informativos. O Dispositivo não é conectado a nenhum tipo de equipamento.</p>	
21 SOFT DRAIN-SYSTEM/ 22124 22120 22122 22125 22121 22126 22127	82673289033	<p>O SOFT DRAIN SYSTEM consiste em um dreno redondo de silicone e um saco coletor com saída.</p> <p>Promove a drenagem suave e possui quatro furos atraumáticos deslocados lateralmente e uma abertura central suavemente arredondada.</p> <p>Configuração do sistema: O saco coletor pré-anexado permite a utilização como sistema fechado instantaneamente. É indicado para drenagem por gravidade de fluídos em feridas semiabertas.</p>	
22 REDON SET WITH TROCAR/ 20567 20568 20569 20918	82673289034	<p>O Redon Set with Trocar é um sistema de drenagem de feridas de alto vácuo, indicado para drenagem, coadaptação e fixação das bordas de uma ferida.</p> <p>É composto por um reservatório evacuado (alto vácuo), que é conectado através da tubulação de conexão a um dreno, a fim de promover sucção/limpeza de sangue e secreção. A escala e display de vácuo que está fixado na garrafa não é aferido ou calibrado, é apenas para fins informativos.</p> <p>O Dispositivo não é conectado a nenhum tipo de equipamento</p>	

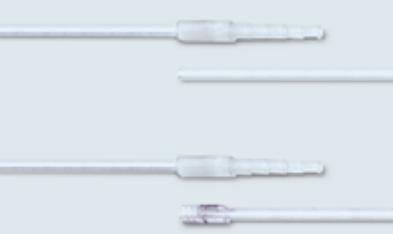
<p>23 REDON-MINI-SETS/ 20604 20608 20651 20652 20653 20654</p>	<p>82673289035</p>	<p>O fole manualmente compressível do Conjunto Redon-Mini utiliza baixo vácuo (aproximadamente 10.000 Pa inicialmente) para pós-operatório de drenagem de feridas. O Conjunto Redon-Mini inclui um dreno e uma agulha de aço inoxidável pré-instalada. Usando material transparente o fluido drenado pode ser rapidamente avaliado. A conexão por plugue ou parafuso é usada para uma conexão rápida e segura.</p>	
<p>24 SOFT-DRAIN SINGLE/ 21935 21937 21936 21939 21931 21933 21945 21934 21932 21930 21938</p>	<p>82673289037</p>	<p>O SOFT DRAIN SINGLE consiste em um dreno redondo de silicone que é destinado a ser conectado ao reservatório de baixo vácuo (objeto de outro registro). Promove a drenagem suave e possui quatro furosatraumáticos deslocados lateralmente e uma abertura central suavemente arredondada. O dreno não é conectado a nenhum equipamento.</p>	

<p>25 SOFT DRAIN FLAT ACTIVE/ 0615-0102 0615-0072</p>	<p>82673289044</p>	<p>O Soft-Drain Flat Active consiste em um dreno plano de silicone e um reservatório de baixo vácuo para drenagem de feridas assistida por sucção. O reservatório incluído cria uma pressão negativa e auxilia ativamente a sucção da drenagem. As nervuras internas do dreno plano evitam o colapso mesmo em alturas mais altas, pressões ou quando um vácuo é aplicado. O acoplamento suave e contínuo entre o dreno e o tubo permitem a segurança e remoção suave dos drenos inseridos</p>	
<p>26 SOFT-DRAIN FLAT SINGLE/ 2014-0102 2014-0101 2014-0072 2014-0071</p>	<p>82673289047</p>	<p>O Soft-Drain Flat Single consiste em um dreno plano de silicone para drenagem de feridas semiabertas por gravidade. As nervuras internas do dreno plano evitam que ele desmorone mesmo em pressões mais altas ou quando um vácuo é aplicado. O acoplamento suave e perfeito entre o dreno e o tubo permite a remoção segura e suave do dreno completamente. Após ser acoplado ao saco coletor o sistema opera instantaneamente.</p>	

<p>27 Dispo Flow/ 22573 22553 22533 22575 22555 22535</p>	<p>82673289041</p>	<p>Consiste em um dreno redondo de silicone 100% médico. O Dispo-Flow é uma alternativa ao penrose de látex convencional para drenagem. É adequado para drenagem de feridas em indicações quando a aplicação de vácuo é contraindicada, mas é necessário desempenho de drenagem suficiente.</p>	
<p>28 Koelner Drainage/ 20385 20384</p>	<p>82673289031</p>	<p>O reservatório Koelner é um reservatório para drenagem de feridas pós-operatórias sem sucção. Permite a drenagem da ferida em áreas onde são utilizados drenos Redon (outro registro) sem pressão negativa. O reservatório Koelner é conectado a um tubo de conexão que poderá ser acoplado a dois tipos de dreno fabricados pela PFM mepro: OR system (para utilizar no pós operatório imediato) e o Ward system (para ser trocado durante o tratamento do paciente). Sendo mais uma opção quando o especialista não precisa de reservatórios que produzam vácuo.</p>	

		Sistema que opera instantaneamente.	
<p>31 LOW VACUUM ACESSORIES/ 20780</p>	82673289046	<p>O reservatório de Baixo Vácuo possui grande capacidade para evacuação manual em tecidos sensíveis usando um baixo vácuo constante.</p> <p>A aplicação suave com sua grande capacidade em comparação com outros baixos sistemas de vácuo, este sistema para evacuação manual com baixa sucção garante drenagem suave da ferida em tecido sensível.</p> <p>Possui duas válvulas unidireccionais para evitar o refluxo, minimizando assim o risco de retrocesso dos fluidos e infecções de feridas.</p> <p>O Reservatório faz parte dos acessórios destinados a serem utilizados em conjunto com o Low Vacuum System um sistema de drenagem de feridas (faz parte de outro registro) quando a troca desse reservatório se faz necessária.</p>	

<p>32 Rendon Drains/ 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027</p>	<p>82673289048</p>	<p>Os Redon Drains perfurados são adequados para drenagem pós-operatória de feridas em alto vácuo. Os drenos devem ser colocados na área da ferida e conectados a um reservatório de sucção. A secreção será eliminada da área da ferida ao longo da perfuração do dreno. O Dispositivo não é conectado a nenhum tipo de equipamento</p>	
<p>33 U-Drains/ 20120 20121 20122 20123 20124 20125 20126</p>	<p>82673289043</p>	<p>Os U-Drains perfurados são adequados para drenagem pós-operatória de feridas em alto vácuo. Os drenos devem ser colocados na área da ferida e conectados a um reservatório de sucção. A secreção será eliminada da área da ferida ao longo da perfuração do dreno.</p>	

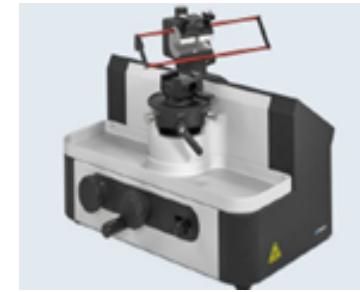
<p>34 U-Drains with Pre Attached Needle 20128 20129 20131</p>	<p>82673289049</p>	<p>Os U-Drains with Pre Attached Needle perfurados são adequados para drenagem pós-operatória de feridas em alto vácuo. Os drenos devem ser colocados na área da ferida e conectados a um reservatório de sucção. A secreção será eliminada da área da ferida ao longo da perfuração do dreno. A agulha pré-anexada, feita de aço inoxidável de alta qualidade o aço sempre fornece uma agulha perfeitamente afiada para colocação.</p>	
<p>35 Redon Connection Tube 20814 20818 20824</p>	<p>82673289039</p>	<p>O tubo de conexão Redon é usado para conexão de Redon ou U-Drains (pertencem a outro registro) ao frasco Redon pré-evacuado em pós-operatório para drenagem de feridas em alto vácuo. O tubo possui conexão plug, luer lock e universal.</p>	

<p>36</p> <p>Soft-Drain Flat Reservoir</p> <p>2013-0620</p> <p>2013-0610</p> <p>2013-0640</p> <p>2013-0615</p>	<p>82673289038</p>	<p>O reservatório plano Soft-Drain Reservoir é um reservatório transparente de silicone de baixo vácuo com válvula anti-refluxo e suporte universal</p> <p>O reservatório cria uma pressão negativa e auxilia ativamente a sucção da drenagem em feridas.</p> <p>A graduação oferece uma visão geral informações sobre os níveis atuais de preenchimento do reservatório, devendo ser trocado quando atingir níveis altos de preenchimento ou perder o vácuo (antes de 30 dias)</p> <p>A válvula anti-refluxo proíbe um refluxo do fluido coletado da ferida na drenagem. Usando o cabide universal, o sistema pode ser facilmente conectado a qualquer leito.</p>	
<p>37</p> <p>Redon-Drains with Pre Attached Needle</p> <p>20067</p> <p>20068</p> <p>20087</p> <p>20097</p>	<p>82673289027</p>	<p>Os Redon-Drains with Pre Attached Needle perfurados são adequados para drenagem pós-operatória de feridas em alto vácuo. Os drenos devem ser colocados na área da ferida e conectados a um reservatório de sucção. A secreção será eliminada da área da ferida ao longo da perfuração do dreno. A agulha pré-anexada, feita de aço inoxidável de alta qualidade o aço sempre fornece uma agulha perfeitamente afiada para colocação.</p>	

<p>38 REDON-MINI-SETS (reservatório) 20650 20611 20657</p>	<p>82673289028</p>	<p>O fole manualmente compressível utiliza baixo vácuo (aproximadamente 10.000 Pa inicialmente) para pós-operatório de drenagem de feridas. Usando material transparente o fluido drenado pode ser rapidamente avaliado. A conexão por plugue ou parafuso é usada para uma conexão rápida e segura.</p>	
<p>39 LOW VACUUM SYSTEM COM TROCAR 20771 20770 20772</p>	<p>82673289029</p>	<p>O Sistema de Baixo Vácuo é um sistema de drenagem de feridas de grande capacidade para evacuação manual em tecidos sensíveis usando um baixo vácuo constante. A aplicação suave com sua grande capacidade em comparação com outros baixos sistemas de vácuo, este sistema para evacuação manual com baixa sucção garante drenagem suave da ferida em tecido sensível. Possui duas válvulas unidireccionais para evitar o refluxo, minimizando assim o risco de retrocesso dos fluídos e infecções de feridas. O conjunto pré-configurado consiste em, tubo de conexão, conector Y, 2 drenos Redon e uma agulha guia descartável (trocár</p>	

<p>40 ASEPT Drainage Line Set/ P09080006</p>	<p>82673289045</p>	<p>A linha de drenagem ASEPT® tem a finalidade de se conectar ao cateter de drenagem pleural ou peritoneal ASEPT® para uma sucção de fluidos patológicos ou aumentados, a fim de restaurar um estado normal. Um adaptador para tubo de drenagem está incluído. O material não é conectado a nenhum tipo de equipamento. O Fabricante recomenda a troca ou retirada da linha de dreno antes dos 30 dias de uso.</p>	
<p>41 ASEPT® Replacement Valve P09080005</p>	<p>82673289040</p>	<p>A válvula de substituição ASEPT® destina-se a substituir a válvula anexada ao ASEPT® Pleural ou Peritoneal Cateter de Drenagem em caso de oclusão ou mau funcionamento.</p>	
<p>PFM Titanium</p>			
<p>42 TiLOOP Instruments Set 6000625</p>	<p>82673280012</p>	<p>Os TiLOOP® Instruments Set reutilizáveis e não estéreis são fabricados em aço inoxidável cirúrgico em conformidade com a norma DIN EN ISO 7153-. Os TiLOOP® Instruments Set apoiam a implantação de redes para pavimento pélvico TiLOOP® ginecológicas e urológicas para reposição da continência urinária, bem como para a reconstrução de pavimentos pélvicos com anomalias. Os TiLOOP® Instruments Set são utilizados em conjunto com os implantes de</p>	

		rede para pavimento pélvico TiLOOP®. São instrumentos de uso transitório que podem ser reutilizados.	
43 TiLOOP Instruments 6000624 6000626	82673280017	<p>Os TiLOOP® Instruments reutilizáveis e não estéreis são fabricados em aço inoxidável cirúrgico em conformidade com a norma DIN EN ISO 7153-1 e estão disponíveis em vários formatos. Os TiLOOP® Instruments estão disponíveis individualmente. Os TiLOOP® Instruments apoiam a implantação de redes para pavimento pélvico TiLOOP® ginecológicas e urológicas para reposição da continência urinária, bem como para a reconstrução de pavimentos pélvicos com anomalias. Os TiLOOP® Instruments são utilizados em conjunto com os implantes de rede para pavimento pélvico TiLOOP®. São instrumentos de uso transitório que podem ser reutilizados.</p>	
PFM GMBH			
44 ROTARY 3004 M 300310	82673280019	<p>O PFM Rotary 3004M é um micrótomo rotativo manual moderno projetado para preparação de secções finas de tecidos humanos e amostras de tecidos animais de dureza variável, desde que sejam adequadas para corte manual. O dispositivo pode ser usado para todas as aplicações no uso para diagnóstico in vitro, pesquisa e medicina relacionadas a exame in vitro dentro do processo histopatológico. Os cortes obtidos com o micrótomo poderão auxiliar o</p>	 pfm Rotary 3004 M (manual)

		patologista na avaliação de condições fisiológicas ou patológicas das amostras de tecido	
45 PFM ROTARY 3006 EM 0300610	82673280023	O pfm Rotary 3006 EM é um micrótomo rotativo moderno e totalmente eletrônico projetado para preparação de secções finas de tecido humano e amostras de tecido animal de dureza variável, desde que sejam adequadas para corte. O dispositivo pode ser usado para todas as aplicações na indústria, pesquisa e medicina como auxílio diagnóstico relacionado a um exame in vitro dentro do histopatológico processo. Só pode ser operado por pessoal devidamente treinado. Os cortes obtidos com o produto deverão auxiliar o patologista na avaliação da condição fisiológica ou patológica das amostras de tecido.	
46 PFM SLIDE 4004 M 400410	82673280024	O pfm Slide 4004 M é um slide manual moderno micrótomo projetado para preparação de seções finas de amostras de tecidos humanos e animais de dureza variável, como desde que sejam adequados para corte manual. O dispositivo pode ser usado para todas as aplicações na indústria, pesquisa e medicamento como auxílio diagnóstico relacionado a um estudo in exame dentro do processo histopatológico. Isto só pode ser operado por pessoal devidamente treinado. Os cortes obtidos com o produto deverão auxiliar o	

		patologista na avaliação do estado fisiológico ou condição patológica das amostras de tecido.	
<p>47 PFM ROTARY 3005 E 0300510</p>	82673280022	O pfm Rotary 3005 E é um moderno sistema rotativo semieletrônico micrótomo projetado para gerar finas seções de humano e amostras de tecido animal de dureza variável, desde que o tecido é adequado para corte manual. O instrumento pode ser usado para todas as aplicações na indústria, pesquisa e medicamento como auxílio diagnóstico em conexão com estudos in vitro exame como parte do processo histopatológico. Pode ser operado apenas por pessoal devidamente treinado. As seções obtidas usando o dispositivo destinam-se a ajudar o patologista na avaliação do estado fisiológico ou patológico condição das amostras de tecido	
<p>48 FORCEPS PFM EWF600 600600</p>	82673280025	O PFM FORCEPS EWF 600 é o primeiro dispositivo eletrônico sem fio desenvolvido para transferência segura e alinhamento, de amostras de tecido humano e animal, durante a realização de exame em laboratório de diagnóstico in vitro, nas áreas de medicina, pesquisa e indústria. Este pode ser usado como um auxílio no diagnóstico relacionado a um estudo in vitro exame dentro do processo histopatológico e só pode ser operado por pessoal devidamente treinado. O produto facilita a preparação de	

		amostras de tecidos que, após processamento adicional, são diagnosticados por um patologista e fornecer informações sobre o estado fisiológico ou patológico das doenças	
49 SLIDE 4005 E 400510	82673280024	O PFM Slide 4005 E é um moderno micrótomo eletrônico de lâminas projetado para preparação de secções delgadas de seres humanos e amostras de tecido animal de dureza variável, desde que são adequados para corte. O dispositivo pode ser usado para todas as aplicações na indústria, pesquisa e medicina como auxílio diagnóstico relacionado a um exame in vitro dentro o processo histopatológico. Só pode ser operado por pessoal devidamente treinado. As seções obtidas com o produto devem auxiliar o patologista na avaliação da condição fisiológica ou patológica do tecido amostras.	

131 produtos aprovados em 49 processos.